



# Checklist afkoppelen


## Easypump® II




1. Was en desinfecteer je handen volgens voorschrift.

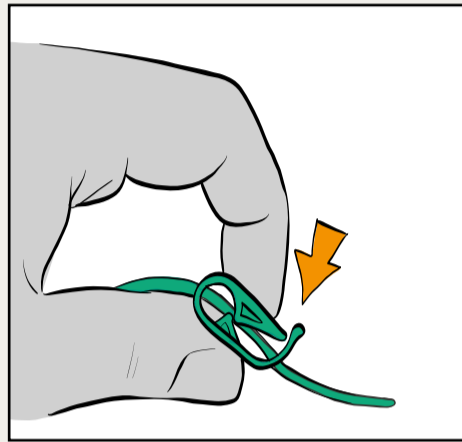


2. Sluit de klem

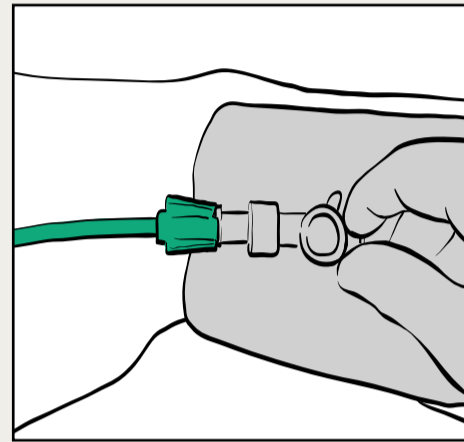


3. Sluit, indien nodig, de toegangspoort van de patiënt.

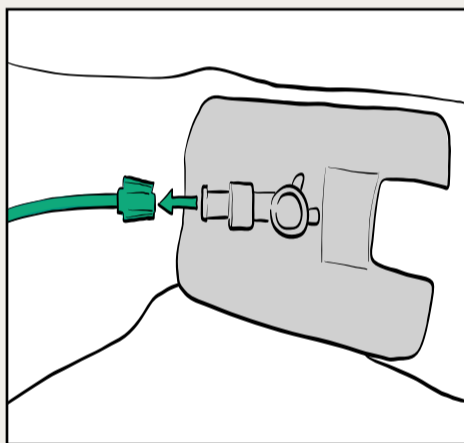


4. Koppel Easypump® II los van de intraveneuze toegangspoort.

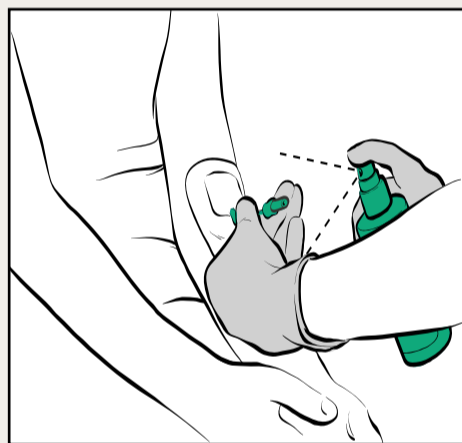

5. Desinfecteer de intraveneuze toegangspoort.

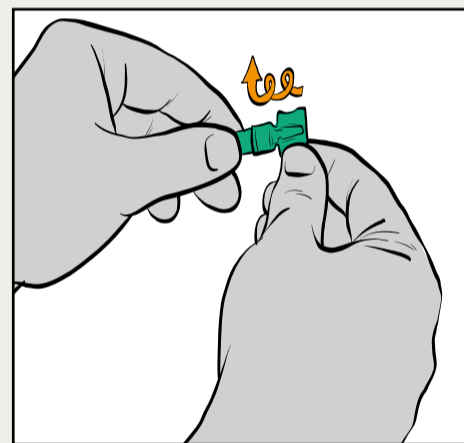

6. Plaats de afsluitdop weer op Easypump® II.

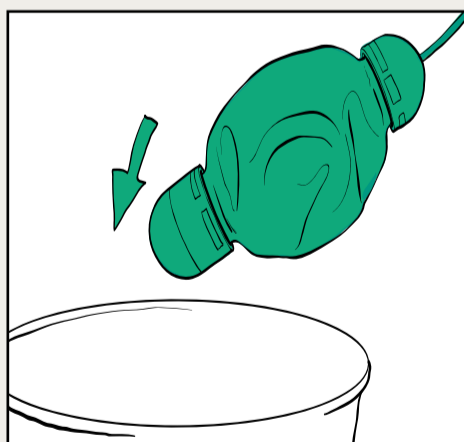

7. Verwijder de pomp volgens voorschrift.